

EZ/263/146/1615/2013

Łódź, dnia 23.12.2013 r.

Nr sprawy 146/ZP/13

**dotyczy:** postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego i wyposażenia dla oddziałów szpitalnych oraz wyposażenia 6 stanowisk laboratoryjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

#### ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

- I. Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759) przekazujemy Państwu odpowiedzi na zapytania złożone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W toku postępowania zostały zadane następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

#### **Pakiet 1: Sprzęt medyczny i wyposażenie dla oddziałów szpitalnych Pozycja 5 KOSZE NA ODPADY MEDYCZNE DLA SOR Z BLOKIEM OPERACYJNYM –2szt**

1. Czy Zamawiający dopuści stelaże wykonane ze stali kwasoodpornej z łyżką pedału z tworzywa, wyposażone w pokrywy z ABS w 8 kolorach do wyboru? Pokrywa z tworzywa ABS jest cichsza od pokrywy metalowej, a kolorystyka umożliwia sortowanie bielizny / odpadów.  
Pokrywy z tworzywa ABS produkowane przez naszą firmę przeszły pozytywnie testy na 1000 otwarć, są trwałe i odporne na uderzenia, można je dezynfekować.  
Łyżka pedału z tworzywa ABS posiada żłobienia, dzięki którym powierzchnia pedału jest antypoślizgowa, co zwiększa funkcjonalność wózka.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

2. Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach 6600x485x950mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

3. Czy Zamawiający dopuści wózek z kółkami o średnicy 75 mm? Jest to parametr wyższy od opisanego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

4. Czy Zamawiający dopuści wózek z kółkami bez dodatkowego hamulca, jeśli mechanizm pedału jest skonstruowany tak, że jego przyciśnięcie hamuje wózek?

Hamulce w tak małych wózkach z reguły nie są wykorzystywane a wpływają na zwiększenie ceny.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pakiet 1: Sprzęt medyczny i wyposażenie dla oddziałów szpitalnych Poz. 6 WÓZEK DO BIELIZNY DLA ODDZIAŁU REUMATOLOGII , ODDZIAŁU KLIN. INTERNY DZIEC. I ALERGOLOGII-3szt**

5. Czy Zamawiający dopuści wózek, którego konstrukcja nośna wykonana jest ze stali kwasoodpornej a wypełnieniem jest płyta meblowa pokryta laminatem z krawędziami zabezpieczonymi plastikiem?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

6. Czy Zamawiający dopuści wózek, gdzie jedna półka jest w połowie jego wysokości a druga stanowi zarazem dno wózka?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

7. Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach: 100 x 490 x 1100mm?


**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pakiet 1: Sprzęt medyczny i wyposażenie dla oddziałów szpitalnych Pozycja 5 KOSZE NA ODPADY MEDYCZNE DLA SOR Z BLOKIEM OPERACYJNYM –2szt**

8. Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach 660x485x950mm?  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**


**Pakiet 1: Sprzęt medyczny i wyposażenie dla oddziałów szpitalnych**  
**Poz. 6 WÓZEK DO BIELIZNY DLA ODDZIAŁU REUMATOLOGII, ODDZIAŁU KLIN. INTERNY DZIEC. I**  
**ALERGOLOGII-3szt**

9. Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach: 1000 x 490 x 1100mm?

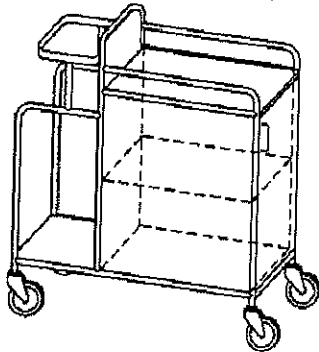

**UWAGA: na szkicu bez pokrywy**  
**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

10. Czy Zamawiający dopuści wózek składający się z szafki z dwuskrzydłowymi drzwiami (z możliwością przymocowania do ścian bocznych za pomocą magnesów) o wymiarach 600x550x1090 mm (szer./dł./wys.) z zamontowaną z tyłu obręczą do worków o wym 480x380 mm?

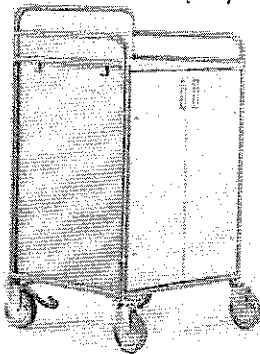


**UWAGA: szafka z obręczą do worków na tylnej ścianie, 2 kółka z blokadą (na zdjęciu bez)**

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pakiet 1: Sprzęt medyczny i wyposażenie dla oddziałów szpitalnych**  
**Poz. 9 WÓZEK DO PRZEWOŻENIA PREPARATÓW HISTOPATOLOGICZNYCH DLA BLOKU**  
**OPERACYJNEGO – 1 szt.**

11. Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach 1055x640x1440 mm (szer./gł./wys.) i pojemności 714 litrów?

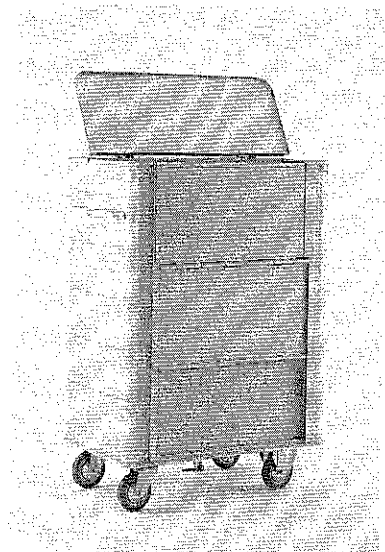

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

12. Czy Zamawiający dopuści wózek z kółkami o średnicy 160 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**


13. Czy Zamawiający dopuści wózek bez hamulca na jedno koło?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

14. Czy Zamawiający dopuści wózek z hamulcem centralnym? Jest to parametr wyższy od opisanego.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

15. Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach 1045x650x800 mm (dł./szer./wys.) z pokrywą na zawiasie ale bez opuszczanej ściany przedniej?

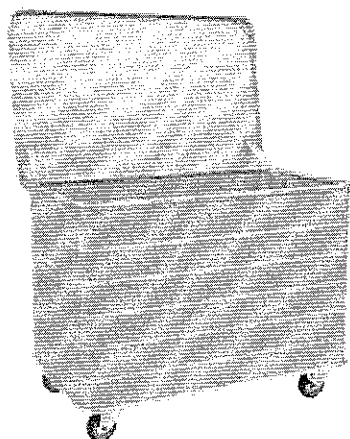

16. Czy Zamawiający dopuści wózek o wys. 800 mm bez kurka spustowego?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

17. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 5 kosz pedałowy na odpady – kosz o wysokości 710mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

18. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 6 mały wózek do przewożenia bielizny – wózek o wymiarach: 1170x670x1100mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

19. Czy Zamawiający dopuści przedłużenie terminu realizacji do 4 tygodni od dnia podpisania umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

20. "Czy zamawiający żąda aby stelaże stołów laboratoryjnych były wyposażone w osłony tylne, czy też można zaoferować stoły bez osłon?"

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby stoły laboratoryjne spełniały wymogi opisane w punkcie 9 Załącznika nr 3 do SIWZ.**

21. Czy osłony mogą być wykonane z płyty laminowanej, tak samo jak szafki podwieszanie, w celu dobrego dopasowania barw osłon i szafek?"

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Poz. 2 krzesła z tworzywa sztucznego na stelażu metalowym**

22. Czy Zamawiający dopuści krzesło na stelażu metalowym o wymiarach całkowitych 800 x 530 x 420.? Opis zgodny z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Poz. 4 wózek platformowy**

23. Z informacji otrzymanych od producenta wózek opisany w SIWZ nie istnieje. Parametry zostały ulepszone. Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach zgodnych z opisem, posiadający platformę z płyty wodoodpornej, antypoślizgowej o gr. 12 mm i nośności aż 400 kg.?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Poz. 5 kosze na odpady medyczne**

24. Czy Zamawiający dopuści wózek – stelaż o wymiarach dł 755 x szer. 450 x wys. 680mm .? Posiadamy w swojej ofercie wózek o wysokości 860mm ale jest on przystosowany na worki 120l.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Poz. 6 wózek do bielizny**

25. Proszę o doprecyzowanie czy szafka, drzwiczki, półka w wózku ma być wykonana ze stali kwasoodpornej?

**Odpowiedź: Tak, zgodnie z SIWZ ze stali kwasoodpornej.**

26. Czy Zamawiający dopuści wózek wykonany z płyty meblowej laminowanej dwustronnie, na konstrukcji z profili aluminiowych lub aluminiowych lakierowanych?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

27. Czy Zamawiający dopuści wymiary dł 1050 x szer. 580 x wys 1100 mm ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Poz. 9 wózek do przewożenia preparatów histopatologicznych**

28. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia histopatologicznych z kołami o średnicy 160 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.**

**Dotyczy pakiet 1 poz 7 (TABORETY DLA ODDZIAŁU UROLOGII) – 18 szt**

29. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taborety z profili stalowych malowanych proszkowo, z siedziskiem tapicerowanym dostępnym w różnych kolorach i łatwym w utrzymaniu czystości, wysokość 470 mm, średnica siedziska 355 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

30. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taborety na stelażu chromowanym, z siedziskiem tapicerowanym dostępnym w różnych kolorach i łatwym w utrzymaniu czystości, wysokość 520 mm, średnica siedziska 360 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

31. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania taborety na stelażu stalowym satynowym, z siedziskiem tapicerowanym dostępnym w różnych kolorach i łatwym w utrzymaniu czystości, wysokość 470 mm, średnica siedziska 355 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Lecznictwa  
dr n. med. Przemysław Biliński